

■ ジェイエスエスブースのご案内 第 30 回日本消化器関連学会 週間展示会

日時 2022年10月27日(木)~29日(土)

10月27日(木)9:00~17:00 / 10月28日(金)9:00~17:00 / 10月29日(土)9:00~17:00

会場 マリンメッセ福岡A館 1Fアリーナ ブースNo.39

展示製品



STERIS

Endoscopy

CoinTipSM SNARE



コインチップスナア

CoinTipSM Snare


ExactoSM Cold snare



エグザクト コールドスナア

ExactoSM Cold Snare


eTRAPSM polyp trap

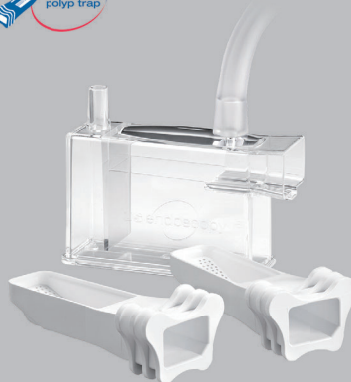

イートラップ ポリープ回収用トラップ

eTrapSM Polyp Trap

BioVacSM direct suction device

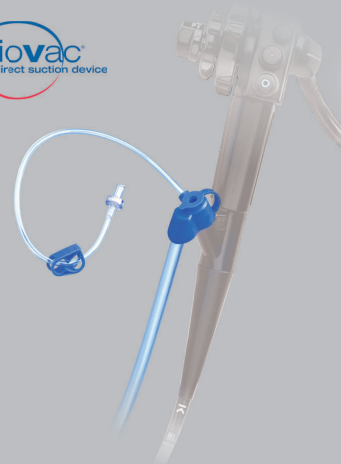

バイオバック

BioVacSM
Direct Suction Device

alesi surgical



サージカルスモーク除去装置

ULTRAVISION

UNIMAX
UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.



ロボット・バルーン・オプティカル

サージカルロックカー

FasmedoSM
Medical Originality



LED・録画・配信

ワイヤレスヘッドライト
カメラセット


製造販売元



JSS 株式会社ジェイ エス エス

消化器内視鏡・消化器外科の融合展示ブース


国内外ともに知名度の高い STERIS Endoscopy(旧 US endoscopy)の幅広い GI ラインナップをはじめ、陰イオンで手術煙を除去するシステム、ロボット用を含むトロッカー、LED 照射と録画・配信できるヘッドギア等、内科・外科の両領域にわたる **新製品を実演** しております。ぜひ、お立ち寄りください。

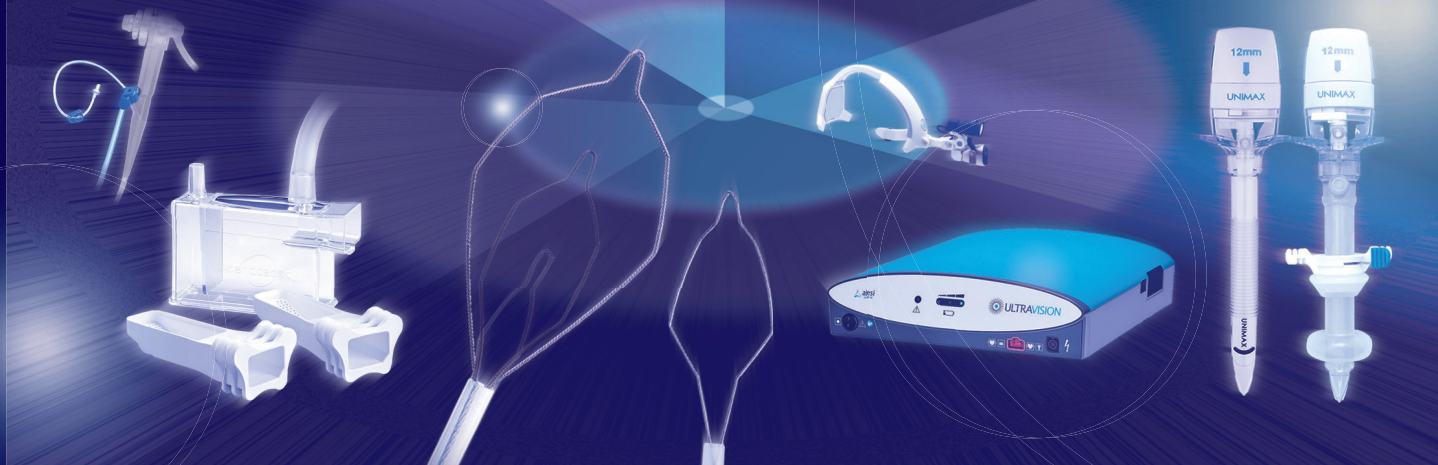

学会会場のご案内



出展ブース場所のご案内

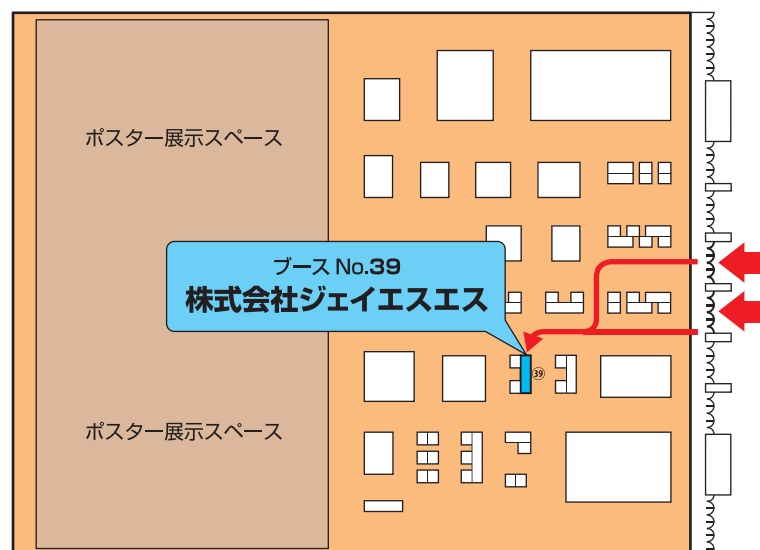

販売名:バイオバック ダイレクトサククションデバイス 医療機器届出番号:27B1X00040000191 クラスI

販売名:ディスプレイ内視鏡用スネア 医療機器認証番号:228ADBZX00051000 クラスII

販売名:イートラップ ポリプ回収用トラップ 医療機器届出番号:27B1X00040000188 クラスI

販売名:エグザクト コールドスネア 医療機器届出番号:27B1X00040000196 クラスI

販売名:Ultravisionビジュアルフィールドクリアリングシステム 医療機器承認番号:22800BZI00038000 クラスII

販売名:ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号:228AHBZX00046000 クラスII

法第二条第四項適用外

製造販売元

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本 社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832

